


SIMON BIGART SA

PRELEVEMENT GRAVATS SOUILLES DU 25/09/96

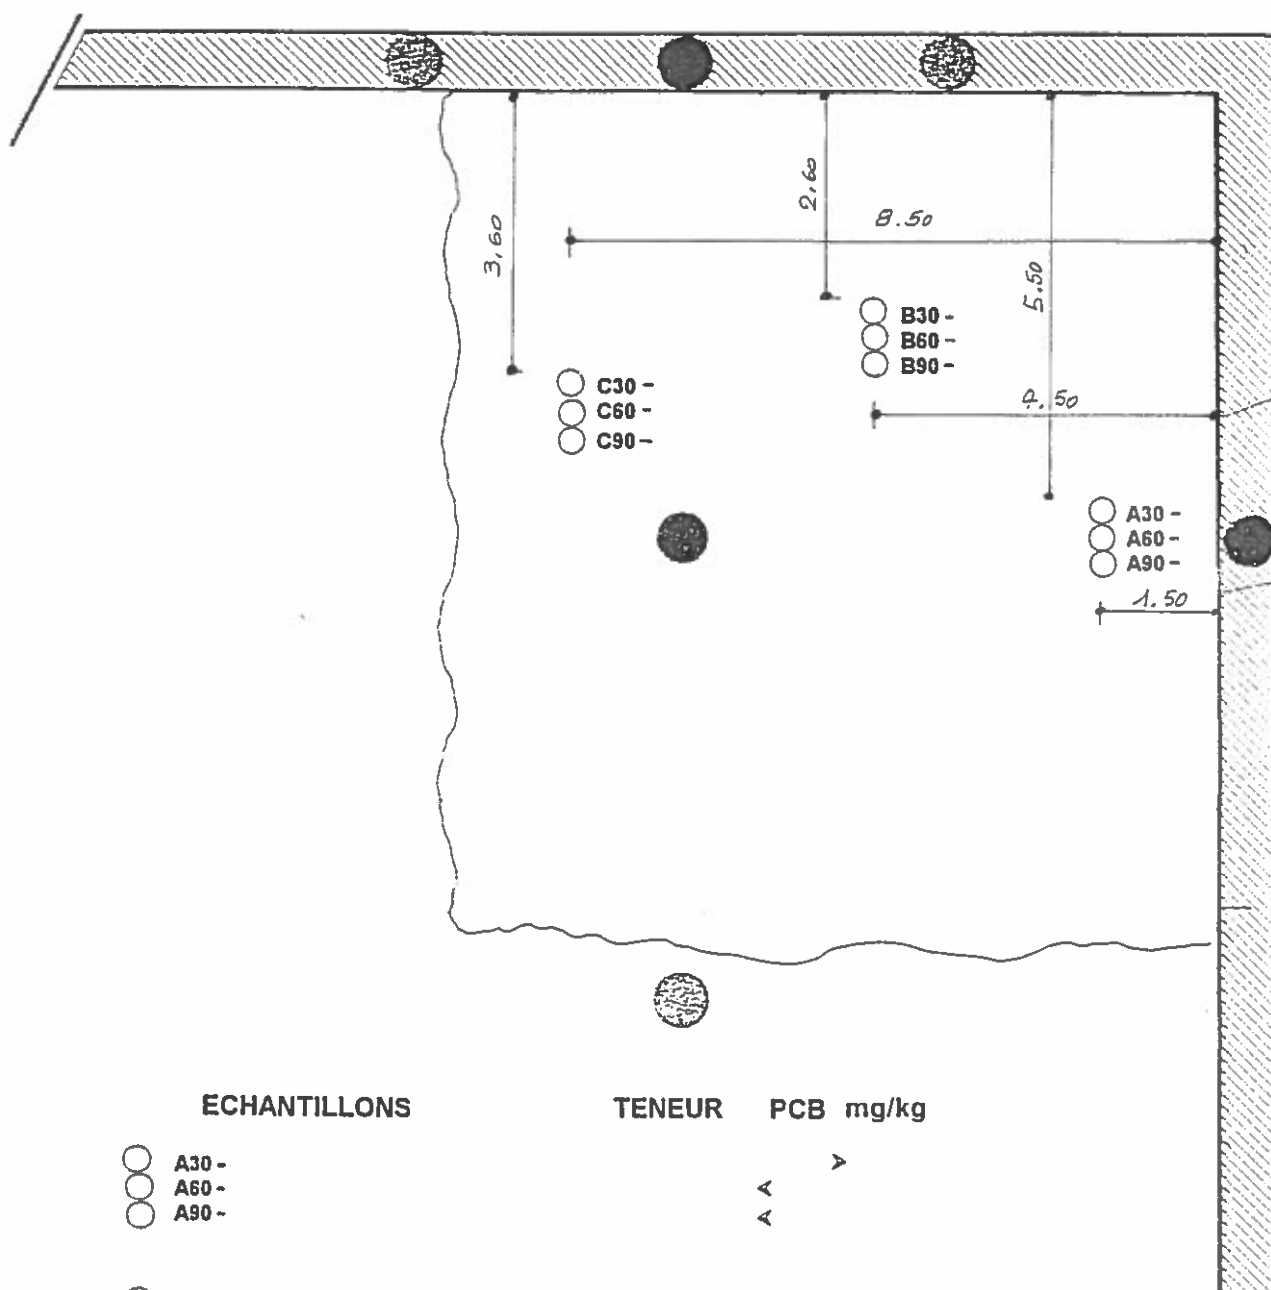

ECHANTILLONS	TENEUR	PCB mg/kg
○ A30 -		>
○ A60 -		<
○ A90 -		<
○ B30 -		<
○ B60 -		<
○ B90 -		<
○ C30 -		<
○ C60 -		<
○ C90 -		<

● Pilier métallique

Laboratoire :

Site Sidérurgique - GANDRANGE
B P 55
57360 AMNÉVILLE
Tél. : 87 67 55 83
Fax : 87 67 25 18

Direction comptabilité :

2 rue Henri Dunant
57070 SAINT-JULIEN-LES-METZ
Tél. : 87 75 20 30
Fax : 87 75 14 44

LCDI

BULLETIN D'ANALYSES PRODUITS DIVERS N°: 96.1000

DU : 26.09.96

NOM DU CLIENT : SIMONT BIGART SA

N°L: 1833

N° DE COMMANDE : 35

NOM DU DEMANDEUR : CHRISTEL

DATE RECEPTION ECHANTILLON : 25.09.96

NOM DU LABORANTIN : MAUSS P

REF DE L'ECHANTILLON : TERRELS SOUILLEES

	PCB (mg/kg)
A3	: 53
A6	: <10
A9	: <10
B3	: <10
B6	: <10
B9	: <10
C3	: <10
C6	: <10
C9	: <10


G MULLER

P KLEITZ




SIMON BIGART SA

PRELEVEMENT GRAVATS SOUILLES DU 06/10/96

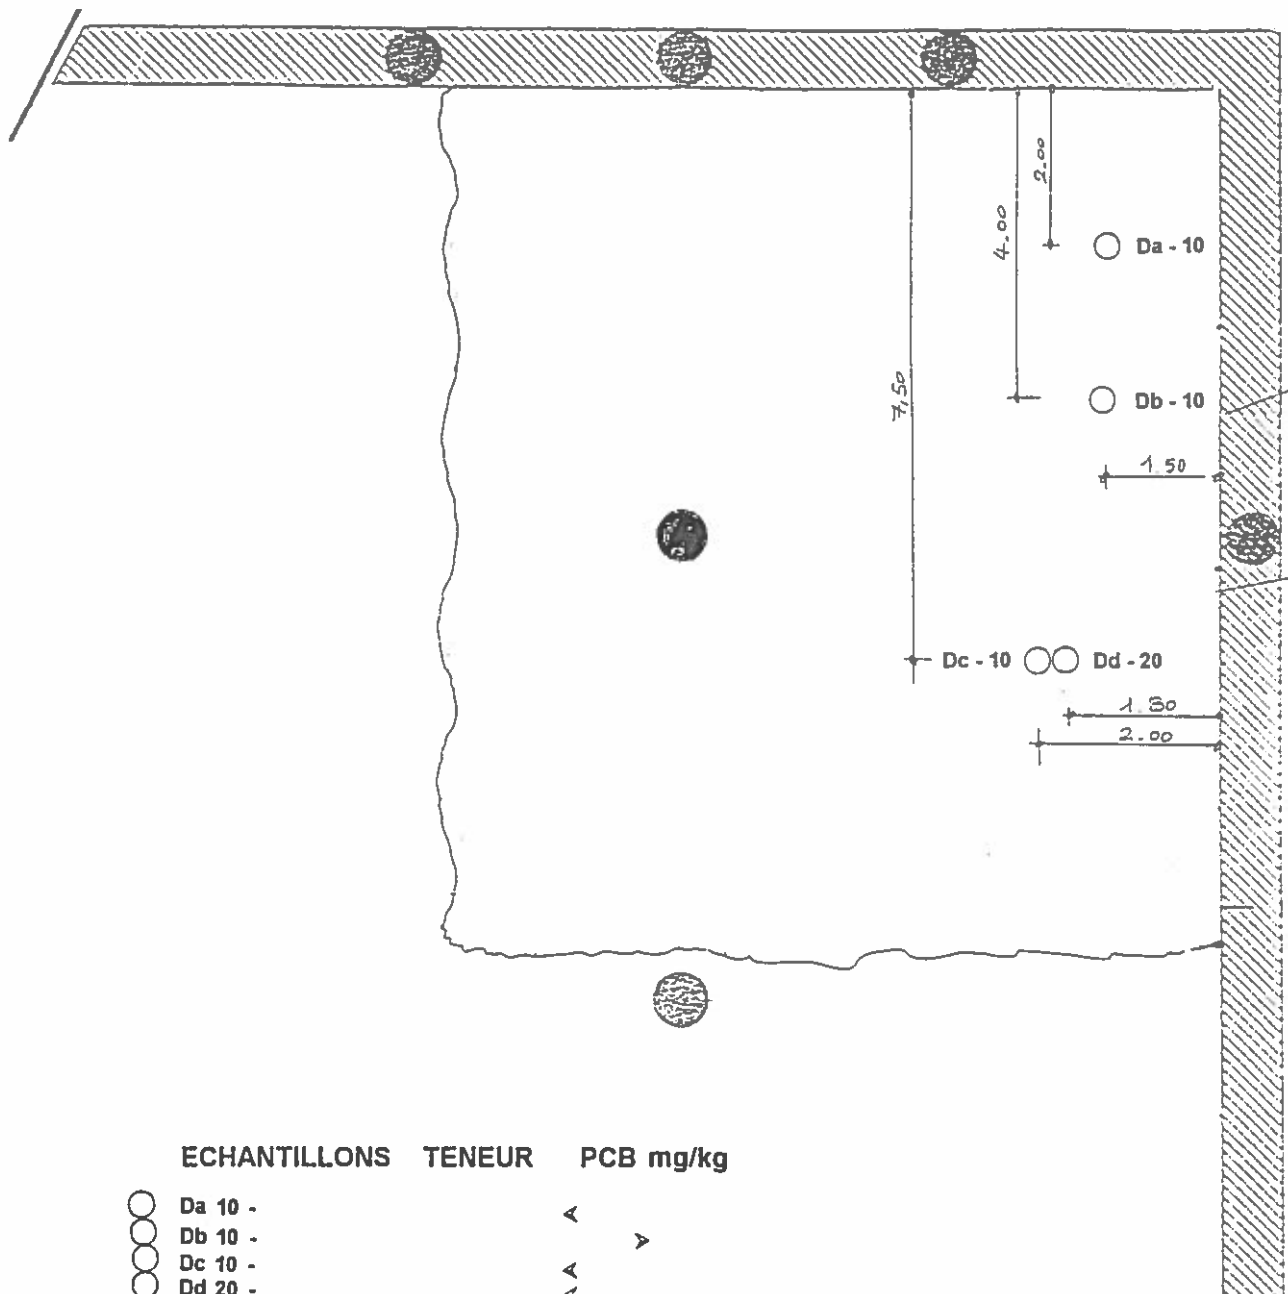

Laboratoire :
Sidérurgique - GANDRANGE
B P 55
57360 AMNÉVILLE
Tél. : 87 67 55 83
Fax : 87 67 25 18

Direction comptabilité :
2 rue Henri Dunant
57070 SAINT-JULIEN-LES-METZ
Tél. : 87 75 20 30
Fax : 87 75 14 44



LCDI

BULLETIN D'ANALYSES PRODUITS DIVERS N° : 96.1029

DU : 07.10.96

NOM DU CLIENT : SIMONT BIGART SA

N° L : 1330

N° DE COMMANDE : n° 39

NOM DU DEMANDEUR : JOST

DATE RECEPTION ECHANTILLON : 04.10.96

NOM DU LABORANTIN : MULLENZ J

REF DE L'ECHANTILLON :

FCD (mg/kg)

FIEZOMETRE HALL POLLUE :	<10
Da -10 :	<10
Db -10 :	12
Dc -10 :	<10
Dd -20 :	<10

G MULLER

P KLEITZ

LABORATOIRE CENTRAL D'ANALYSES INDUSTRIELLES

SA AU CAPITAL DE 300 000 F - CODE APE 731 Z - RC METZ 380 459 198 - SIRET 380 459 198 000 12